

次亜シーAL 安全性の根拠と確認方法

次亜シーAL の製作に於いて、使用材料は、人体への悪影響が無いことの証明として、JFRL 食品分析センターによる検体の結果、有害物質が含有していないことの確認ができています。

また、川崎市宮前区ひまわりクリニック医院長指導の基エンドユーザーの様々な利用局面を考え、より肌に優しく、除菌効果の高い弱酸性域を目指し医療機器専門装置による検査を行い、
現在は PH : 6 前後の安定した製品になっております。

上記の証明としてひまわりクリニック医院長と共同開発をしております。

神奈川ひまわりクリニック

神奈川県川崎市宮前区宮前平三丁目3番地24

TEL 044-853-7001 FAX 044-853-0522

院長 小野 龍 太



次亜ソーAL Ph値検査

日 時 2020年4月29日 (木) AM9 : 30～
場 所 神奈川ひまわりクリニック 院内


(川崎市宮前区宮前平3-3-26)

検査実行


株式会社 環科研 田中 ・ 笹野
神奈川ひまわりクリニック 院長 小野



Ph 5.34

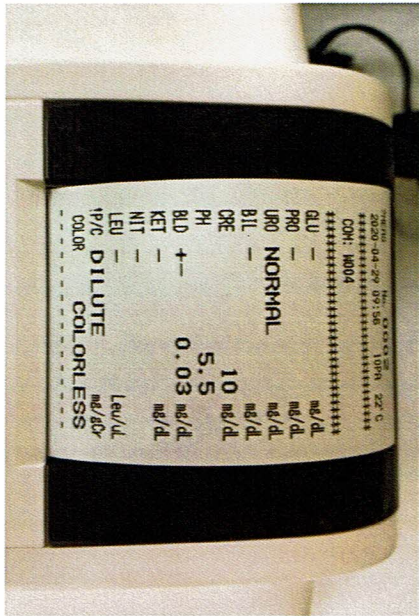

Ph 5.5

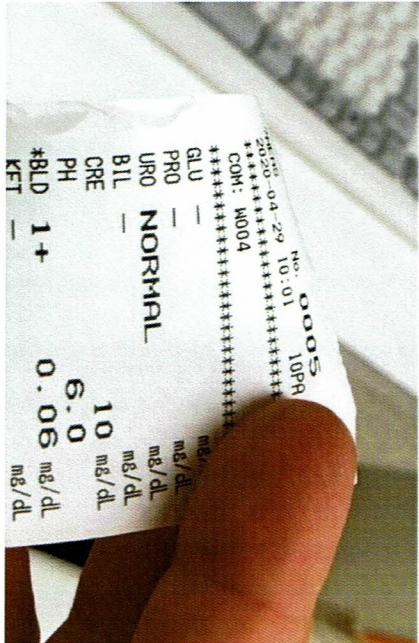

Ph 6.0

神奈川ひまわりクリニック

神奈川県川崎市宮前区宮前平三丁目3番地26

TEL 044-853-7001 FAX 044-853-0622

院長 小野 龍 太

株式会社 環科研



次亜ソーAL　Ph値検査

日　　時　　2020年4月29日（木） AM9：30～
場　　所　　神奈川ひまわりクリニック　院内

（川崎市宮前区宮前平3-3-26）

検査実行

株式会社　環科研　田中　・　笹野
神奈川ひまわりクリニック　院長　小野

